


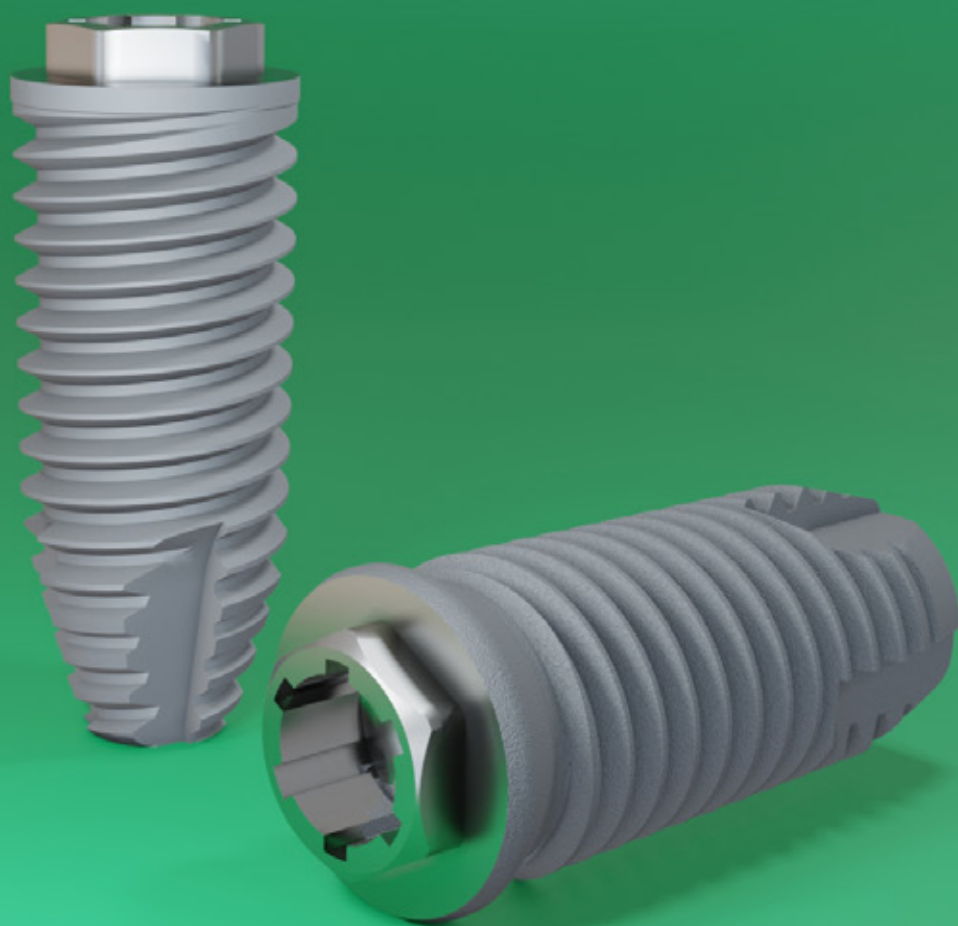

BRANE
Listino/Pricelist

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare BRANE BRANE implant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning - Impianti - Implants	pag. 7
Presca d'impronta Impression taking - Componenti da laboratorio - Lab components	pag. 10
Protesizzazione Prosthetic workflow - Parti protesiche - Prosthetic parts	pag. 12
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture - MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	pag. 16
Strumentario Tools	pag. 22
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 27

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE BRANE BRANE IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO SYSTEM TU. SYSTEM TU. IMPLANT



Connessione esagonale esterna con 6 posizioni per l'abutment (a seconda dell'abutment).

External hexagonal connection with 6 abutment positions (depending on the abutment).

Corpo cilindrico con filetto a due principi

Cylindrical body shape with two-principle threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Bordi di taglio poco profondi sui filetti

Shallow cutting edges on threads

Forma dell'apice: piatta

Apex shape: flat

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SL TITANMED SL TITANMED SURFACE TREATMENT

Il trattamento SL Titanmed è tecnicamente comparabile ai migliori SLA™ maggiormente documentati in letteratura. Viene realizzato con una tecnica di sabbiatura con una tecnologia che permette la massima costanza di trattamento. A questa segue la mordanatura con soluzioni acide. La sabbiatura genera sulla superficie dell'impianto una macrorugosità, a cui si sovrappone una micro-rugosità ottenuta tramite il processo di mordanatura acida. La topografia superficiale che ne deriva genera la struttura idonea all'ancoraggio delle cellule osteoblaste e favorisce un'ottima integrazione dell'impianto con il tessuto osseo.

The Titanmed SL treatment is comparable with the best SLA™ treatments, documented in scientific journals. It is realized using sand-blasting technique with a technology which allows the maximum consistency of treatment. After this, the surface is etched with acid solutions. The sand-blasting step creates a macro roughness on the surface of the implant, then a micro roughness is formed on top of these with the acid etching process. The resulting texture of the surface generates a structure that is suitable for anchoring osteoblast cells, favouring the optimal integration of the implant with the bone tissue.

IMPIANTO SPEEDY GR. TU. SPEEDY GR. TU. IMPLANT



Connessione esagonale esterna con 6 posizioni per l'abutment (a seconda dell'abutment).

External hexagonal connection with 6 abutment positions (depending on the abutment).

Morfologia del corpo lievemente conica

Slightly tapered body shape

Filetto a due principi

Two-principle threads

Trattamento di superficie SL Titanmed, compatibile con i migliori trattamenti SLA™

SL Titanmed surface treatment, compatible with the best SLA™ treatments

Apice conico automaschiante con scanalature di taglio

Tapered self-tapping apex with bone cutting flutes

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE TAPPO COVER SCREW



Titanmed produce viti tappo con l'impronta esagonale 0,90 mm.

Titanmed produces cover screw with the 0,90 hex type impression.

VITE DI CONNESSIONE CONNECTING SCREW



Titanmed le produce con l'impronta tipo UNIGRIP™

Titanmed produces them with the UNIGRIP™ type impression


Le viti di connessione delle parti protesiche nonostante abbiano stesso filetto e impronta possono essere, a seconda del diametro dell'impianto, differenti per lunghezza totale, altezza testa, inclinazione sottotesta, ecc.

The connecting screws of the prosthetic parts have the same thread and the same imprint may be different, depending on the diameter of the implant, in terms of overall length, head height, inclination under the head, etc.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35-45 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	10 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	30 Ncm
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	20 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

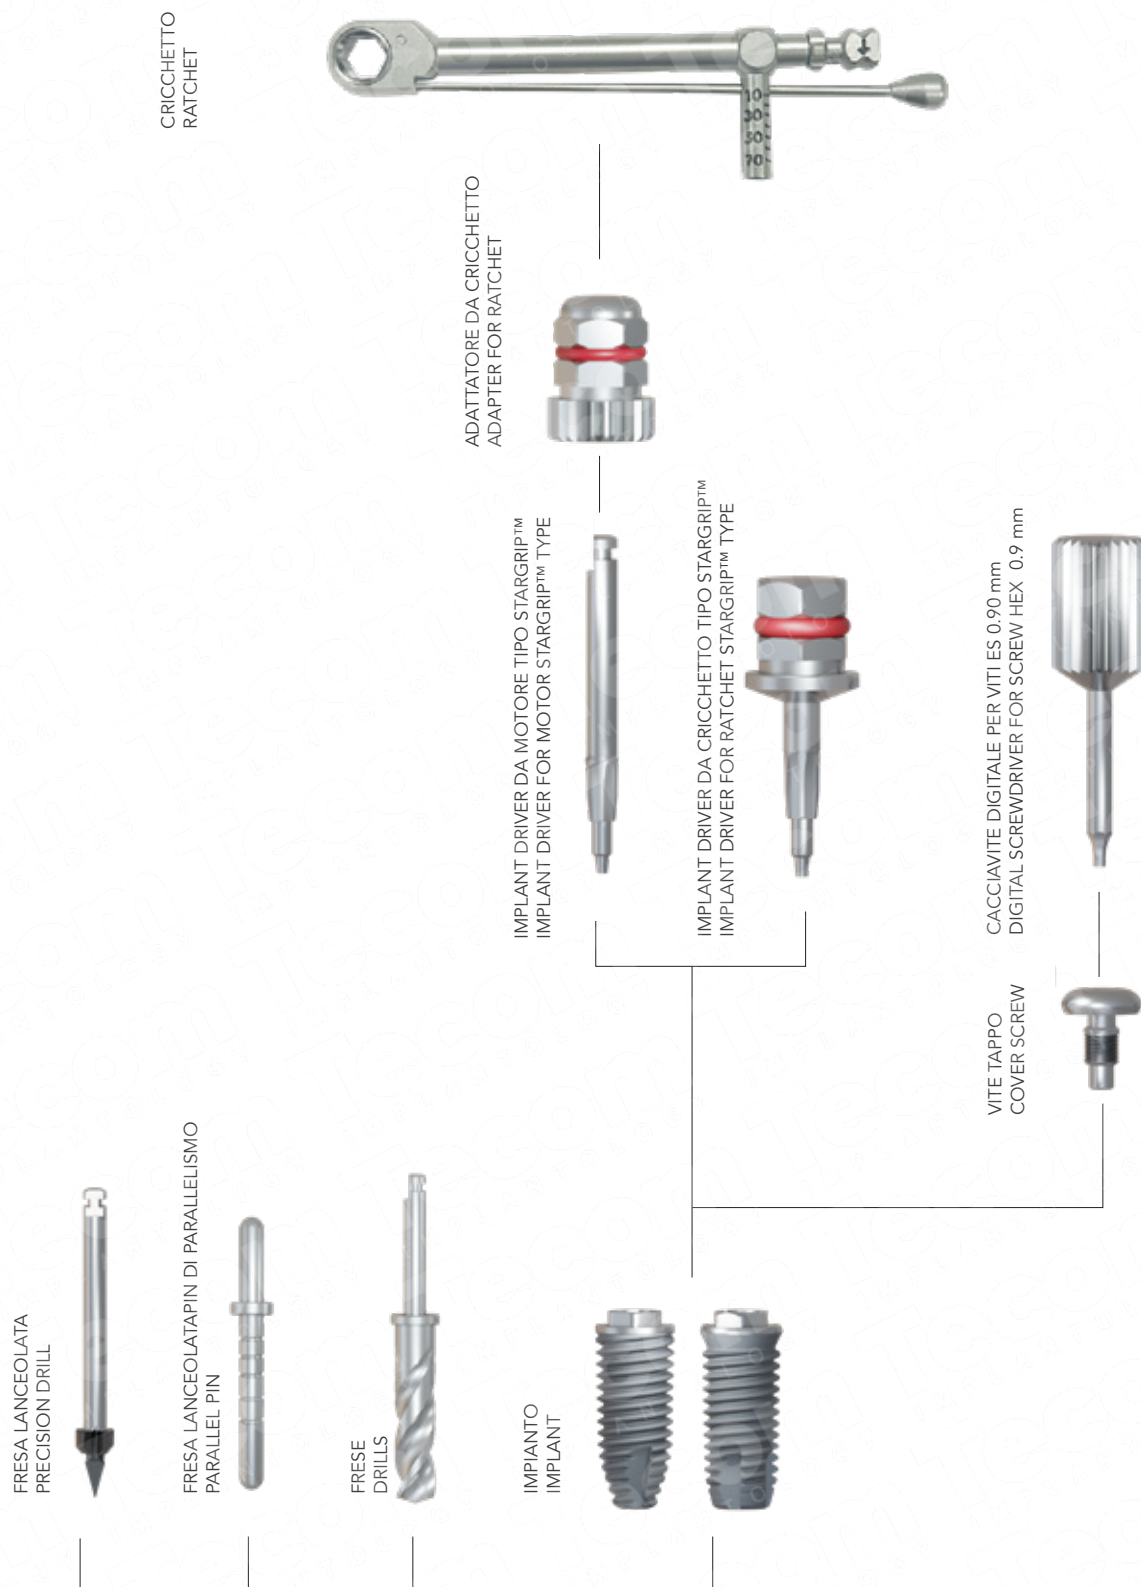

01 IMPIANTI BRANE SYSTEM TU. IMPLANTS BRANE SYSTEM TU.

IMPIANTO SYSTEM TU. Ø3.75
 IMPLANT SYSTEM TU. Ø3.75

Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.




IMPIANTO SYSTEM TU. Ø4.0
 IMPLANT SYSTEM TU. Ø4.0

Vite tappo inclusa.
 Cover screw included.



IMPIANTO SYSTEM TU. Ø5.0
 IMPLANT SYSTEM TU. Ø5.0


Vite tappo inclusa anodizzata secondo
 codice colore.
 Cover screw included anodized according
 to color code.

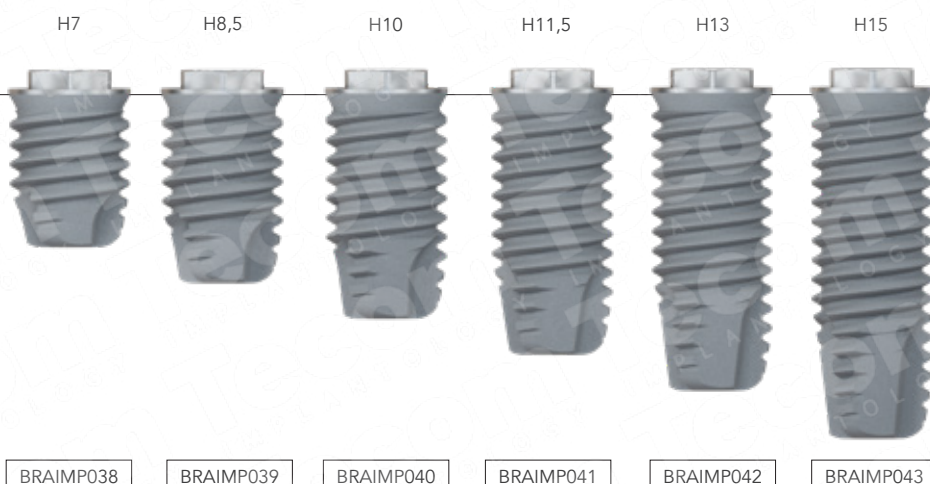

01 IMPIANTI BRANE SPEEDY GR. TU. IMPLANTS BRANE SPEEDY GR TU.

IMPIANTO SPEEDY GR. TU. Ø4.0
IMPLANT SPEEDY GR. TU. Ø4.0

Vite tappo inclusa.
Cover screw included.

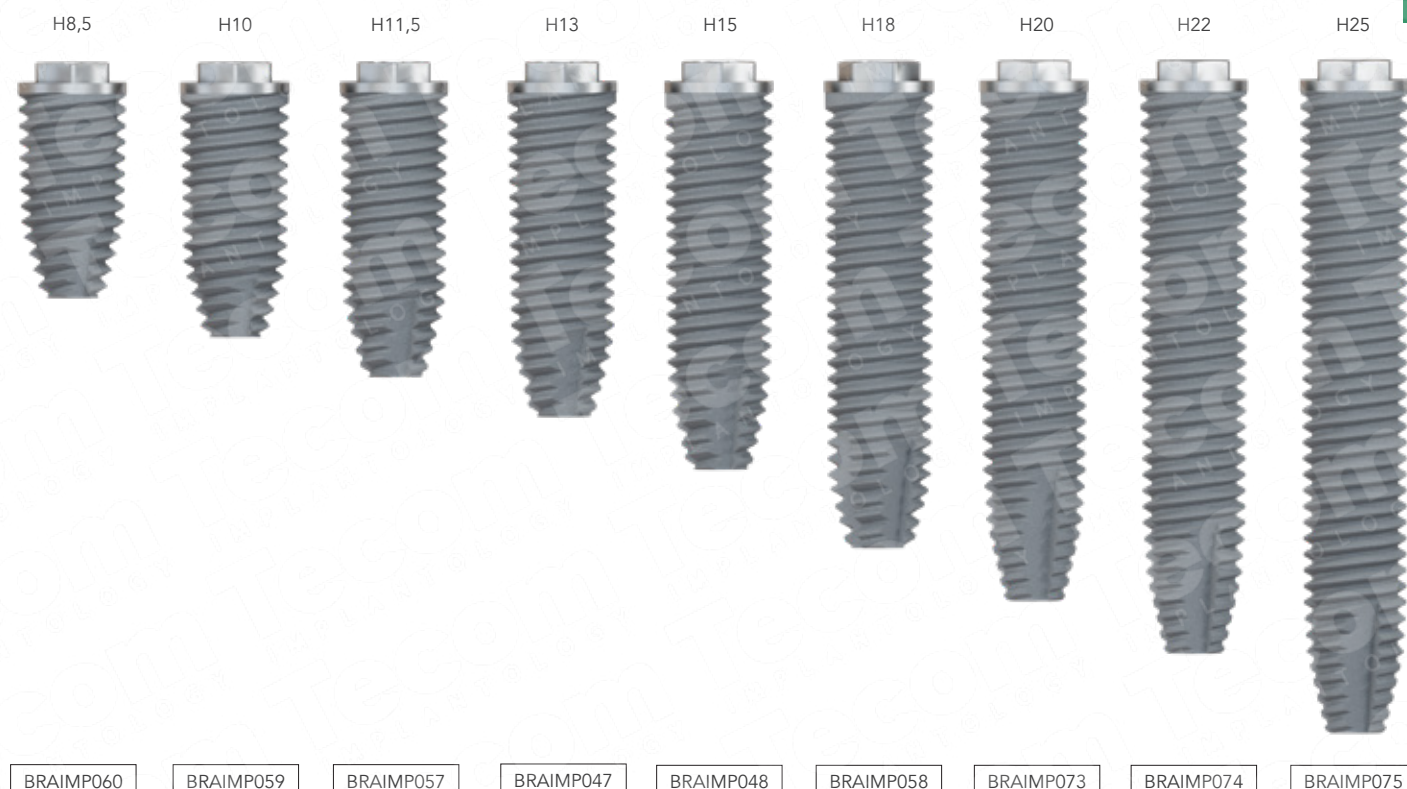

PRESA D'IMPRONTA IMPRESSION TAKING

CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



IMPIANTO
IMPLANT



ANALOGO
IMPLANT REPLICA



02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



Ø

3,75	BRAPPR095
4	BRAPPR095
5	BRAPPR096

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

ANALOGO IMPLANT REPLICA



Ø

3,75	BRAPPR142
4	BRAPPR142
5	BRAPPR067

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES 0.90 mm
 DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREW HEX 0.9 mm



VITE DI GUARIGIONE
 HEALING SCREW



PROVISORIO
 TEMPORARY



TRANSMUCOSO
 TRANSMUCOSAL



DRITTO ESTETICO
 AESTHETIC STRAIGHT



INCLINATO 15°
 ANGLED 15°



TBASE



SOVRAFUSIONE Cr/Co
 Cr/Co BASE CALCINABILE



CALCINABILE
 CALCINABLE



OTK
 BALL ABUTMENT



IMPIANTO
 IMPLANT



CRICCHETTO
 RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
 ADAPTER FOR RATCHET



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
 DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
 DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA
 DAMPING CAP LOW OPEN



CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA
 DAMPING CAP TALL CLOSED



DRIVER PER OTK
 DRIVER FOR OTK



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE (ES. 0,90) HEALING SCREW (HEX. 0,90)



	Ø	H	
		2	4
	3,75	BRAVIT032	BRAVIT033
	4	BRAVIT032	BRAVIT033
	5	BRAVIT034	BRAVIT035

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



Ø	3,75	BRAPPR139
	4	BRAPPR139

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



Ø	3,75	BRAPPR140
	4	BRAPPR140

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE TRASMUCOSO TRANSMUCOSAL ABUTMENT



	Ø	H	
		2	
	3,75	BRAPPR045	
	4	BRAPPR045	
	5	BRAPPR046	

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE ESTETICO DRITTO AESTHETIC STRAIGHT ABUTMENT



		H	
		1	3
Ø	3,75	BRAPPR130	BRAPPR131
	4	BRAPPR130	BRAPPR131

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE INCLINATO 15° 15° ANGLED ABUTMENT



		H	
		1,5	2,5
Ø	3,75	BRAPPR048	BRAPPR049
	4	BRAPPR048	BRAPPR049
	5	BRAPPR050	/

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE TBase TBase ABUTMENT



Ø	3,75	BRAPPR129
	4	BRAPPR129

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included
Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.
Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,75	BRAPPR134
	4	BRAPPR134

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,75	BRAPPR054
	4	BRAPPR054
	5	BRAPPR055

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



MONCONE CALCINABILE ROTANTE ROTATING CALCINABLE ABUTMENT

	3,75	BRAPPR051
Ø	4	BRAPPR051
	5	BRAPPR053

Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included



MONCONE A PALLINA (OTK) BALL ABUTMENT (OTK)

		H	
		1	2
	3,75	BRAPPR069	BRAPPR070
Ø	4	BRAPPR069	BRAPPR070



CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN TITANIO CON O-RING TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING

BRAPPR090

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
 O-RING 10 PCS PACK

BRAPPR105



CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN TITANIO CON O-RING TITANIUM DAMPING CAP TALL, CLOSED WITH O-RING

BRAPPR091

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.
 O-RING 10 PCS PACK

BRAPPR105




BARRETTA DI SALDATURA (10 PZ.) WELDING BAR (10 PCS)


	1.2	VARPPR006
Ø	1.5	VARPPR005
	2	VARPPR004

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

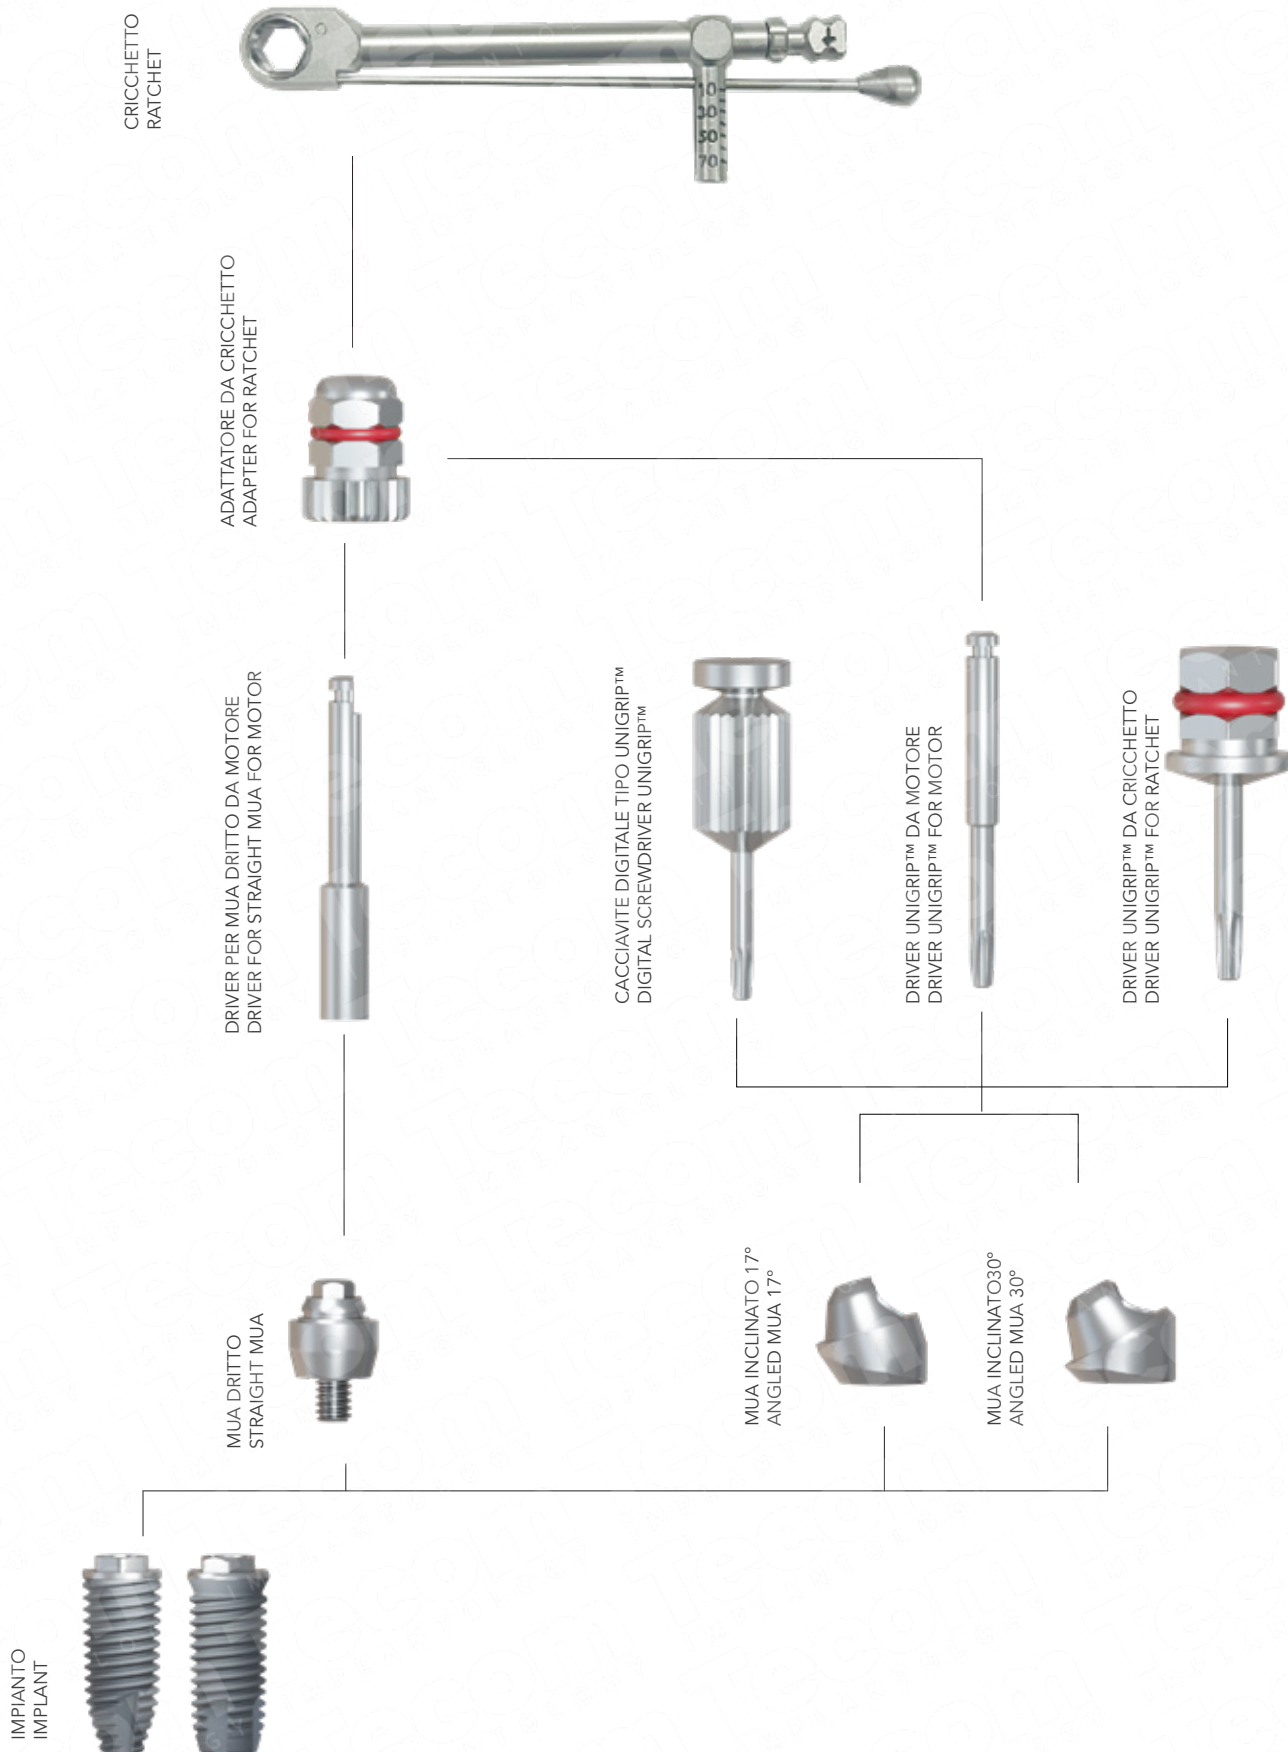


MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

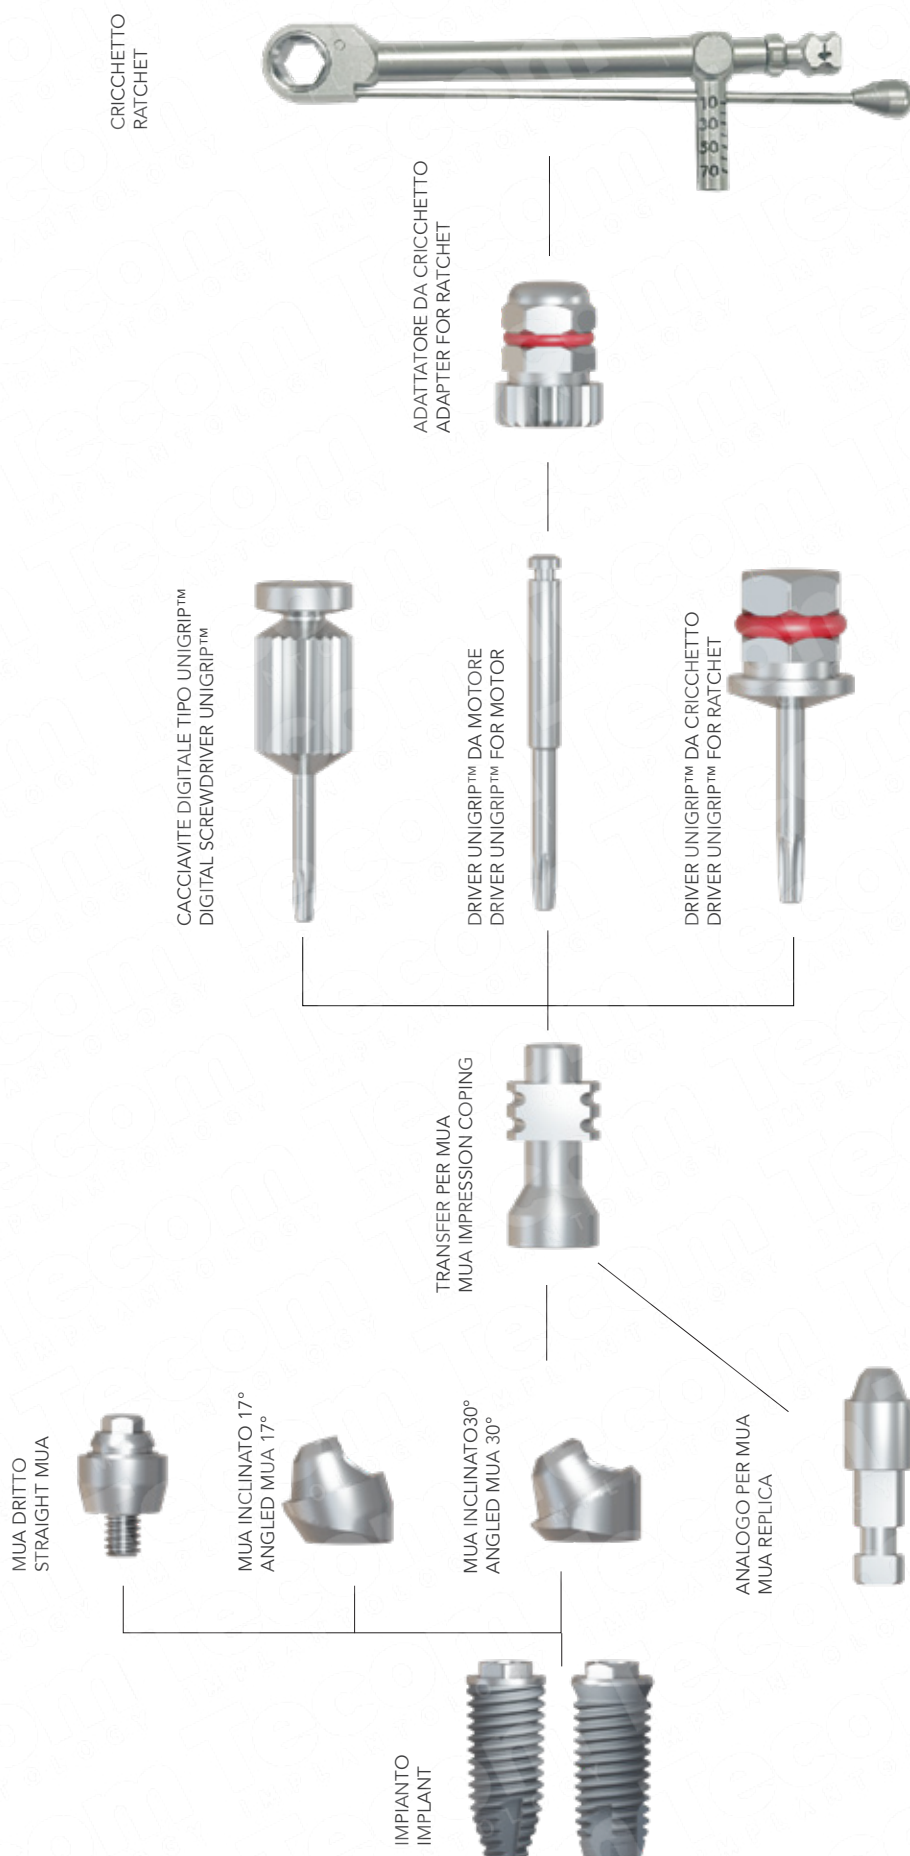

MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

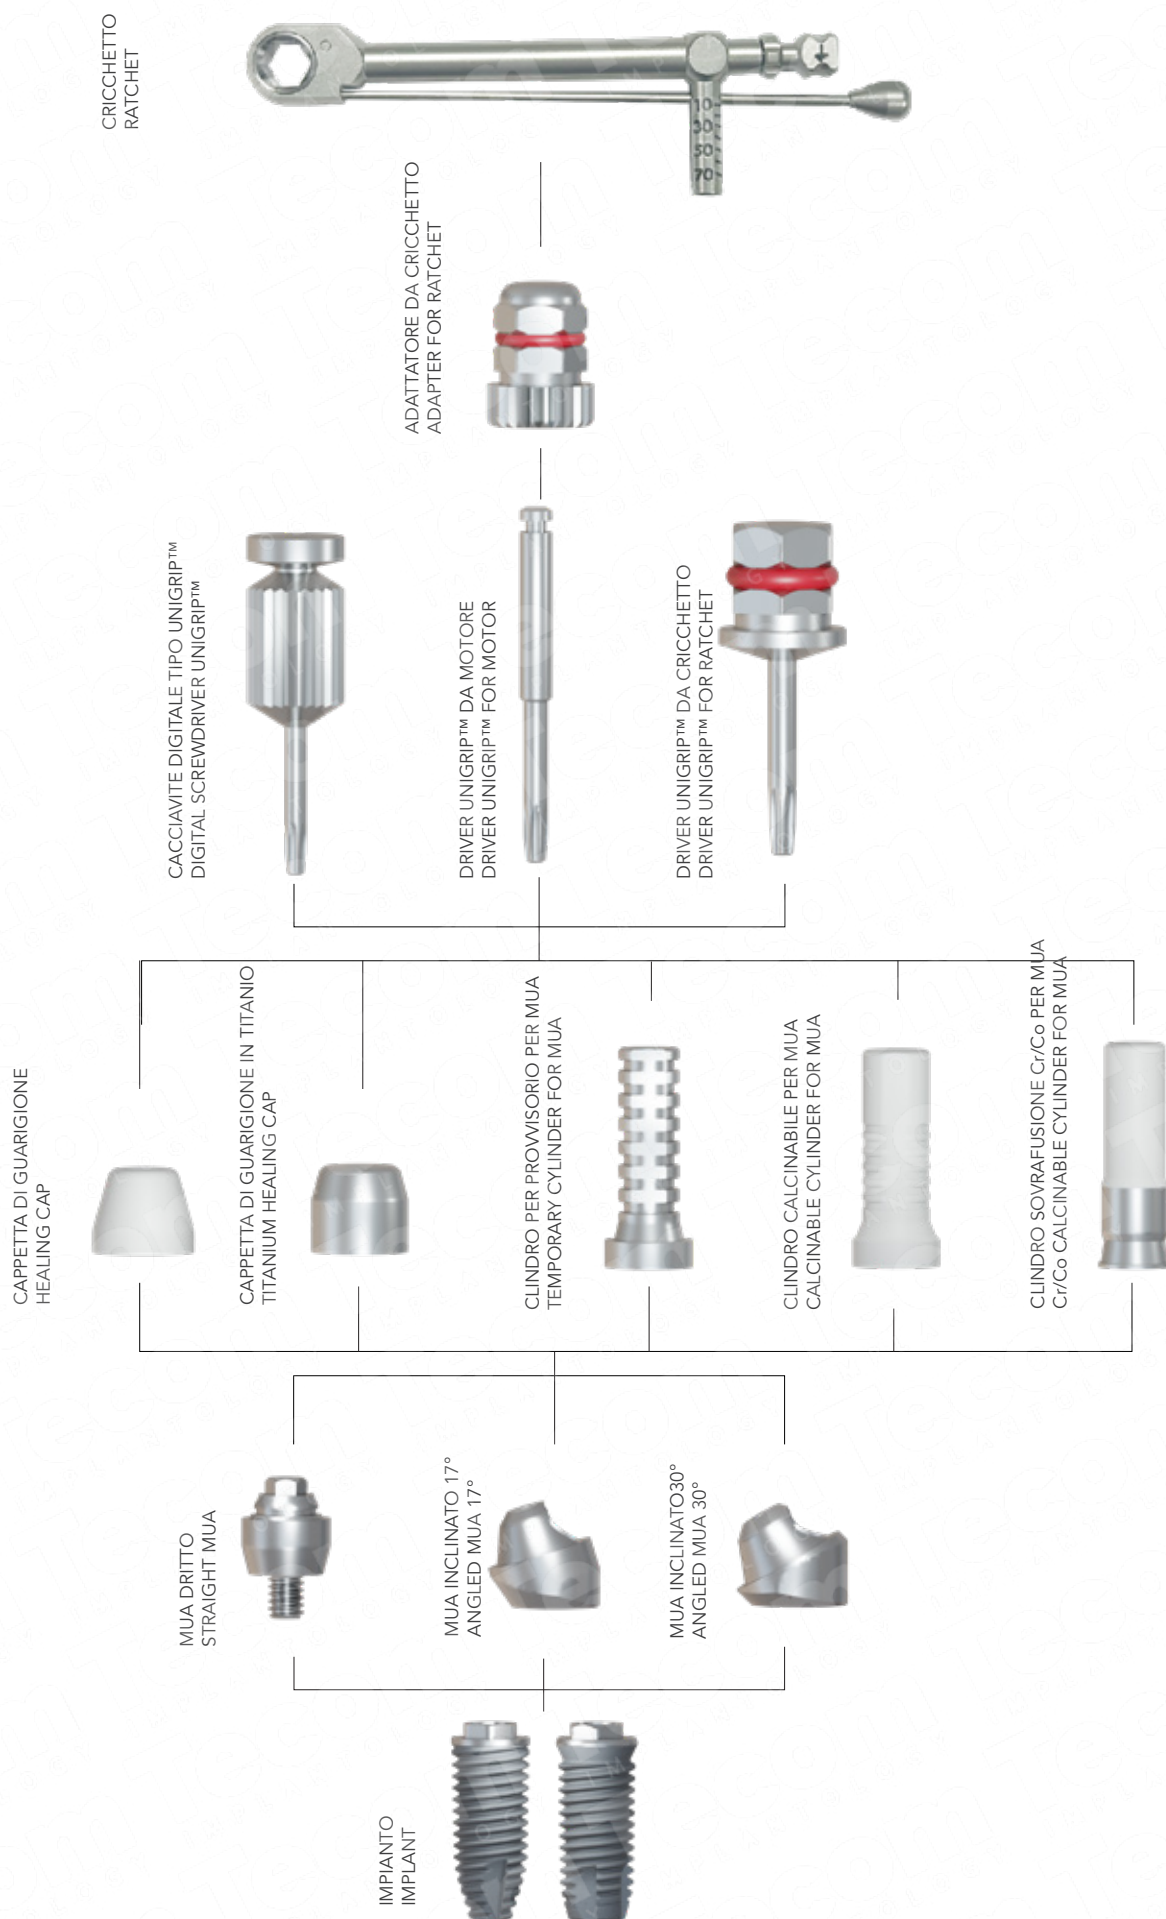

04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



Ø	H			
	1	2	3	4
3,75	BRAPPR074	BRAPPR075	BRAPPR098	BRAPPR099
4	BRAPPR074	BRAPPR075	BRAPPR098	BRAPPR099
5	BRAPPR076	/	/	/

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MUA INCLINATO 17° 17° ANGLED MUA



Ø	H	
	2	3
3,75	BRAPPR103	BRAPPR104
4	BRAPPR103	BRAPPR104



Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



Ø	3	4	5
	3	4	5
3,75	BRAPPR128	BRAPPR089	BRAPPR100
4	BRAPPR128	BRAPPR089	BRAPPR100



Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15
IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15



BRAPPR087

VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA
CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042

ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA



BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA
TITANIUM HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR141

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA
HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR097

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA

BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co
Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA
PRECISION DRILL

VARSTR088



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
MORBIDO
DRILLING PROTOCOL FOR SOFT BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
MEDIO
DRILLING PROTOCOL FOR MEDIUM BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8	3	3,25	3,4	3,55
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR035	/	/	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036	/	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	BRASTR036	/	BRASTR038



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SYSTEM PER OSSO
DURO
DRILLING PROTOCOL FOR DENSE BONE

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2	2,8	3,25	3,4	3,55	4,25
3,3	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	/	/	/
3,75	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR036	/	/	/
4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	/	RSTSTR001	/	/
5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	BRASTR036	/	BRASTR038	BRASTR037



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO MORBIDO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR SOFT BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill		
		1,6	1,8	2
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO MEDIO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR MEDIUM BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill				
		1,6	1,8	2	2,8	3
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	3,25
					/	BRASTR036



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO IMPIANTI SPEEDY GR. PER OSSO DURO

DRILLING PROTOCOL (SPEEDY GR. IMPLANTS) FOR DENSE BONE

		Ø reale fresa - Real Ø drill				
		1,6	1,8	2	2,8	3,4
Ø	4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007	RSTSTR001



PIN DI PARALLELISMO

PARALLEL PIN

Ø	2/2,7	SF0STR122
---	-------	-----------

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



IMPLANT DRIVER TIPO STARGRIP™ DA MOTORE

IMPLANT DRIVER STARGRIP™ TYPE FOR MOTOR

	26	32
3,75	BRASTR019	BRASTR020
4	BRASTR019	BRASTR020
5	BRASTR021	BRASTR022

Ø

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE

ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS



VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titan-med

This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets

IMPLANT DRIVER TIPO STARGRIP™ DA CRICCHETTO

IMPLANT DRIVER STARGRIP™ TYPE FOR RATCHET



	L	
	12	17
3,75	BRASTR055	BRASTR056
4	BRASTR055	BRASTR056
5	BRASTR053	BRASTR054

Ø

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed

It can be used only with Titanmed ratchets

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 0,90

DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 0,90



	L	
	10	15
	BRASTR025	BRASTR018



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™ DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE

L	
12	17
BRASTR004	BRASTR015



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR

L	
26	32
BRASTR001	BRASTR027



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET

L	
12	17
BRASTR057	BRASTR058

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
 It can be used only with Titanmed ratchets



CACCIAVITE DIGITALE PER OTK DIGITAL SCREWDRIVER FOR OTK

BRASTR003



DRIVER PER OTK DA MOTORE DRIVER FOR OTK FOR MOTOR

L
20
BRASTR014



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

		25
Ø	3,75	BRASTR046
	4	BRASTR046



CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR089

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver



CRICCHETTO FISSO TITANMED FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

L
170
VARSTR085

Utilizzabile solo con driver Titanmed
 It can be used only with Titanmed driver



PROLUNGA PER FRESE DRILL EXTENDER

VARSTR032

08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'ed_2024_01 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed. I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the ed_2024_01 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed. The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: export@tecomimplantology.com



www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com